Calibración sonda membrana

La maniobra más importante es la calibración del sensor respecto a una herramienta de contraste (DPD-1…). Se recomienda primero dejar circular el agua por el sensor 4 horas, y entonces proceder con la calibración

Pasos para un C-650, C-640 y C-530

Acceder al menú de Programación pulsando la tecla “ENT”

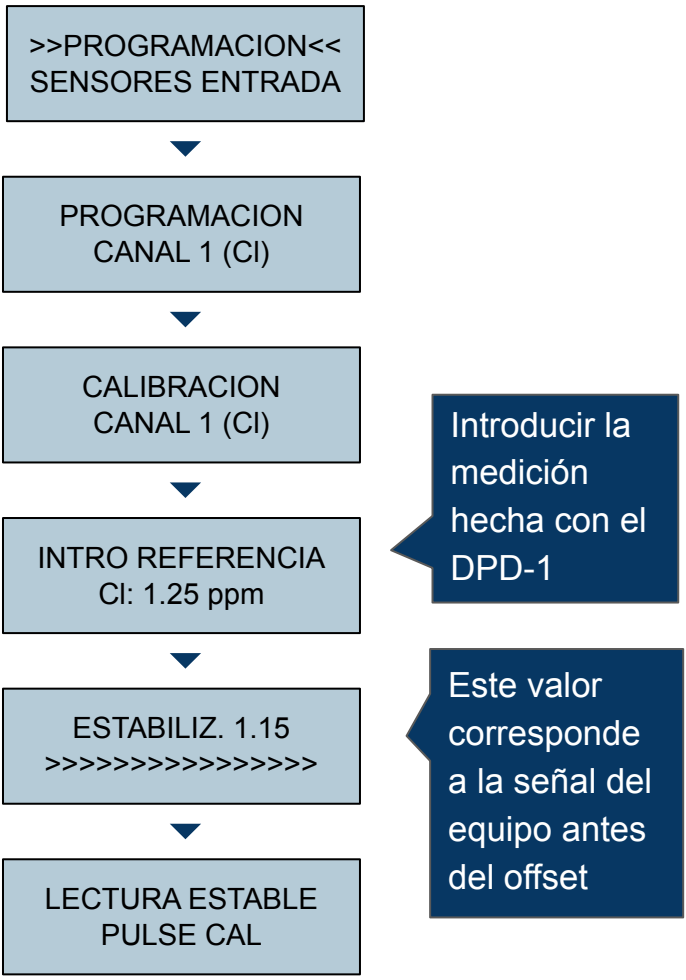

- Mantener el sensor conectado durante todo el proceso
- Dejar circular el agua 4h antes de calibrar el sensor
- No realizar el Offset en este sensor

Si se quiere calibrar el Canal-2, acceder a la PROGRAMACION CANAL 2, para el Canal-3 la PROGRAMACION CANAL 3 y para el Canal-4 la PROGRAMACION CANAL 4